


MicroMega

OBTURATION CANALAIRE

MM Bioceramic Sealer et Putty

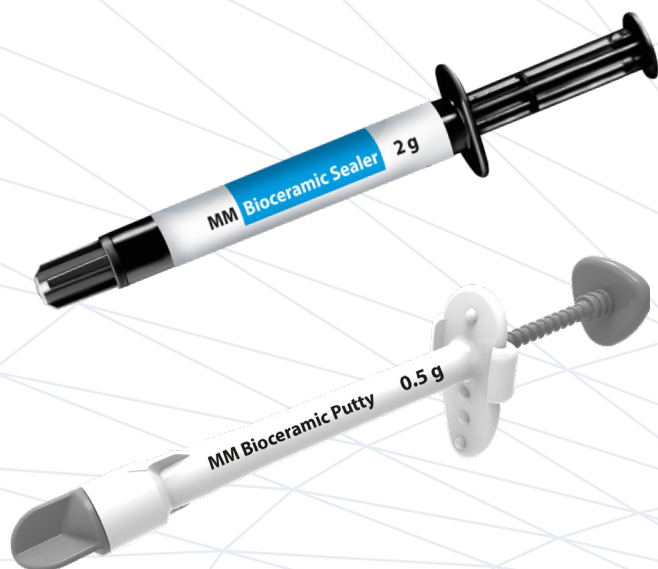

La biocéramique,
nouvelle référence clinique

MM MICRO
MEGA

MicroMega Bioceramic


Les ciments biocéramiques présentent une **forte adhésion** à la dentine, assurent une **excellente étanchéité** en limitant les microfuites et **favorisent la cicatrisation** en stimulant la formation de nouveaux tissus durs, tels que la dentine ou l'os.

Développés conformément aux normes scientifiques les plus strictes, ces biomatériaux offrent une combinaison unique d'excellente capacité d'étanchéité, de biocompatibilité exceptionnelle et de facilité de manipulation et d'utilisation.

Bénéfices

- Application facile
- Réduction bactérienne
- Aide à la cicatrisation
- Régénération naturelle
- Étanchéité optimale

Seringue de 2g + 20 embouts d'application

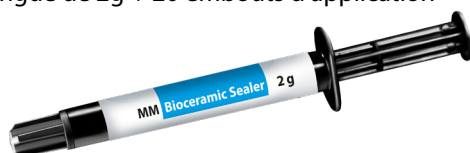


Référence

MM Bioceramic Sealer 65003075

Référence

MM Bioceramic Putty 65003076

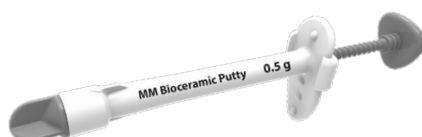

Seringue de 0.5g

MM Bioceramic Sealer

MM Bioceramic sealer est utilisé pour l'obturation canalaire, en combinaison avec un cône de gutta-percha, sous forme d'une fine couche offrant une excellente fluidité et une étanchéité parfaite.

Caractéristiques

- Prêt à l'emploi
- Bioactif
- Alcalinité élevée (pH 12)
- Excellente fluidité
- Haute radiopacité
- Ne tâche pas
- Convient à la technique à froid et à chaud



Temps de travail : 1 h


Temps de prise : 2 h

MM Bioceramic Putty

MM Bioceramic Putty est un matériau plus dense indiqué pour les réparations radiculaires (perforations, résorptions, coiffage pulpaire) ou les obturations rétrogrades en chirurgie endodontique.

Caractéristiques

- Prêt à l'emploi
- Bioactif
- Alcalinité élevée (pH 12)
- Radiopacité élevée

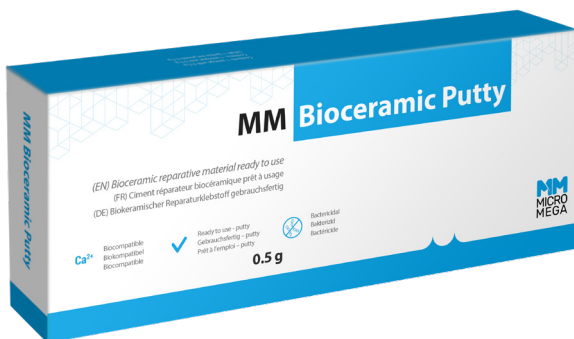

Visitez la page produit !




micro-mega.com

Suivez-nous sur les réseaux !



@micromegasa



Micro-Mega SA



@micromegasa

80000581 - A - 01.26

Fabricant légal :

Angelus

**Indústria de produtos
odontológicos S/A**

Waldir Landgraf Street, 101
Lindoia, Londrina - Brésil

Importé et distribué

par **Micro-Mega SA**

MicroMega MM Bioceramic Sealer and Putty
Publicité | CE 2460 | Dispositif médical de classe IIa
selon le Règlement MDR 2017/745.

Organisme notifié : DNV (det Norske Veritas).

Dispositif médical destiné aux soins dentaires,
réservé à un usage professionnel dentaire,
non remboursé par la Sécurité Sociale.

Voir l'étiquetage du produit et les instructions

d'utilisation sur le site internet : micro-mega.com

CE
2460